Generel information:

- Hvis du oplever medicineringsfejl eller bivirkninger under brug af Awiqli®, skal du straks indberette dem til Novo Nordisk Danmark kundeservice på tlf.: 8020 0240 eller e-mail: kundeservice@novonordisk.com eller til de lokale myndigheder. Søg hjælp hos din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis det er nødvendigt.
- Hvis du tager flere enheder Awiqli®, end du skal, kan dit blodsukkerniveau blive for lavt. Kontrollér dit blodsukker, og indtag om nødvendigt glukosetabletter eller andre sukkerholdige snacks såsom slik, kiks eller frugtjuice.
- Se rådene sidst i indlægssedlen, som findes i pakningen, for at få information om, hvad du skal gøre, hvis dit blodsukkerniveau bliver for højt eller for lavt.
- For at undgå doseringsfejl eller potentiel overdosering må du ikke bruge en sprøjte til at udtage opløsningen fra pennen.
- Brug altid dosistælleren og dosismarkøren til at vælge dosis, og justér omhyggeligt dosisvælgeren for at indstille den ordinerede dosis af Awiqli®. Tæl ikke pennens klik for at vælge dosis.
- Hvis du er blind eller har nedsat syn og ikke kan følge instruktionerne, må du ikke bruge pennen uden hjælp. Få hjælp af en person med godt syn, som ved, hvordan pennen skal bruges.
- Hvis pennen ikke fungerer korrekt, må du ikke forsøge at injicere igen. Kontakt Novo Nordisk Danmark kundeservice på tlf.: 8020 0240 eller e-mail: kundeservice@novonordisk.com.
- Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte din læge.

Referencer:

1. Godkendt produktresumé for Awiqli®. Bagsværd, Danmark: Novo Nordisk A/S; Oktober 2025

FlexTouch® og Awiqli® er registrerede varemærker ejet af Novo Nordisk A/S © Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880 Bagsværd, Danmark; godkendelsesdato: Oktober 2025

Ansvarsfraskrivelse:

- Denne vejledning er udelukkende designet med det formål at give information og minimere risici og bør ikke opfattes som markedsførings- eller reklamemateriale.

Version 1.0

Godkendt af Lægemiddelstyrelsen oktober 2026

Introduktion til ▼Awiqli®

(insulin icodec)

▼ Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i punkt 4 i indlægssedlen, hvordan du indberetter bivirkninger.

Forstå den ugentlige dosering og justering af dosis ved skift til Awiqli®

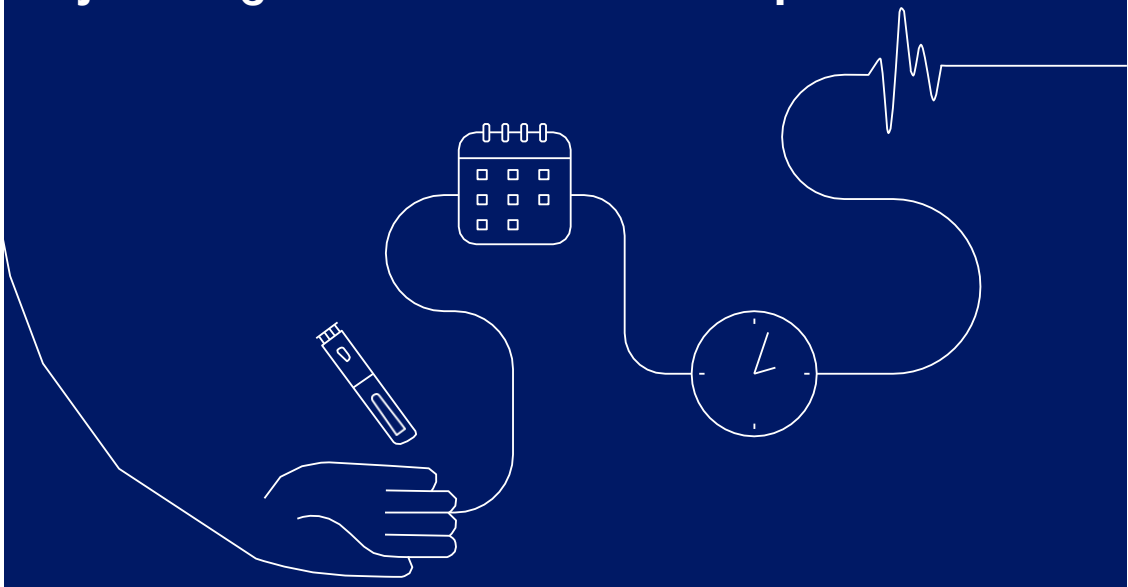

Du har fået ordineret Awiqli® til behandling af din diabetes. Denne brochure har til formål at give dig information for at hjælpe dig med at tage din behandling én gang ugentligt og for at undgå medicineringsfejl.

Hvad er Awiqli®, og hvad bruges det til?

- Awiqli® er en basalinsulinanalog til ugentlig behandling af diabetes hos voksne. Det er et langtidsvirkende insulin, som du kun skal injicere én gang ugentligt for at hjælpe dig med at kontrollere dine blodsukkerniveauer.
- Awiqli® skal kun bruges én gang ugentligt. Du skal sikre dig, at du nøje overholder den ugentlige doseringsplan, som er ordineret af din læge.

Hvad er medicineringsfejl?

Det er vigtigt for dig at forstå, at der kan forekomme medicineringsfejl ved brug af Awiqli®.

- Medicineringsfejl kan forekomme på grund af utilsigtet forveksling mellem Awiqli® og andre insuliner, især hurtigtvirkende insuliner.
- Medicineringsfejl kan også forekomme på grund af forkert indgivelse af Awiqli® doser ved skift fra daglige basalinsuliner til ugentlig dosering, eller hvis du anvender/har anvendt andre antidiabetiske injektionslægemidler til ugentlig indgivelse.
- Tal venligst med lægen for at identificere forskelle i design mellem Awiqli® og andre insulinpenne.
- Før du bruger Awiqli®, skal du omhyggeligt læse brugervejledningen, der følger med pakningen.

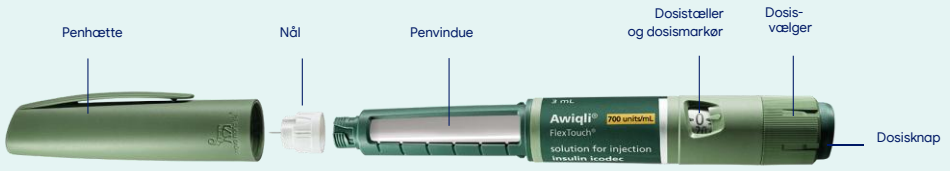

Skift fra andre ugentlige antidiabetiske injektionslægemidler til Awiqli®

- Hvis du anvender/har anvendt andre ugentlige injektionslægemidler, skal du være særlig opmærksom ved valg af dosis på pennen med Awiqli®, da måden, hvorpå dosis vælges på pennen, adskiller sig fra andre ugentlige antidiabetiske injektionslægemidler.
- Sørg for, at du forstår de instruktioner om dosering og håndtering, som du har fået af din læge, før du bruger pennen med Awiqli®.
- Sørg altid for at vælge den korrekte dosis med pennen med Awiqli®, som ordineret af din læge.
- Kontrollér før injektion, hvor mange enheder der er valgt på pennen, for at undgå doseringsfejl og utilsigtet overdosering.
- Indstil aldrig den maksimale enkeltdosis (700 E) på pennen med Awiqli®, medmindre den er ordineret af din læge.
- Hvis du er i tvivl om den ugentlige dosis, skal du kontrollere din recept og kontakte din læge.



Undgå utilsigtede forvekslinger:

- Hvis du bruger mere end ét insulin, skal du altid sikre dig, at du bruger den rigtige insulin ved at kontrollere insulinets navn og koncentration før hver injektion. Inden injektion af Awiqli® skal du sikre dig, at pennens etiket viser 700 enheder/ml.
- Pennen kan levere doser af Awiqli® på 10 til 700 enheder i 1 injektion, i trin på 10 enheder.
- I modsætning til andre insulinpenne, der tillader dosisjusteringer af 1 eller 2 enheder per trin, tillader pennen med Awiqli® dosisjusteringer af 10 enheder ad gangen.
- Kontrollér altid, hvor mange enheder der er valgt, inden den ugentlige insulin injiceres.

Skift fra andre basalinsuliner til Awiqli®

- Når du skifter fra insuliner, der indgives én eller to gange dagligt, til Awiqli®, vil din læge fastsætte din ugentlige dosis på baggrund af din nuværende dosis af basalinsulin og dine blodsukkerniveauer, såvel som andre faktorer.
- Din læge kan beslutte at ordinere en øget første dosis på baggrund af dit behov for blodsukkerkontrol. Denne øgede dosis er kun til den første injektion og skal ikke bruges til den anden og efterfølgende injektioner.
- Inden injektion skal du altid kontrollere, at du har den korrekte ordinerede dosis af Awiqli®, særligt for den første og anden injektion, og du skal altid kontrollere, hvor mange enheder der er valgt.
- Under skiftet til Awiqli® og i de følgende uger efter skiftet, skal du måle dine blodsukkerniveauer oftere.